


Abkürzungen: Fl. = Flüssigkeit, Lsg. = Lösung, Lsgm. = Lösungsmittel

Merke: Konzentrierte Säuren & Basen und chlorierte Lösungsmittel gehören nicht in den Abfluss! Säuren und Basen mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8 können in den Abfluss gegossen werden.

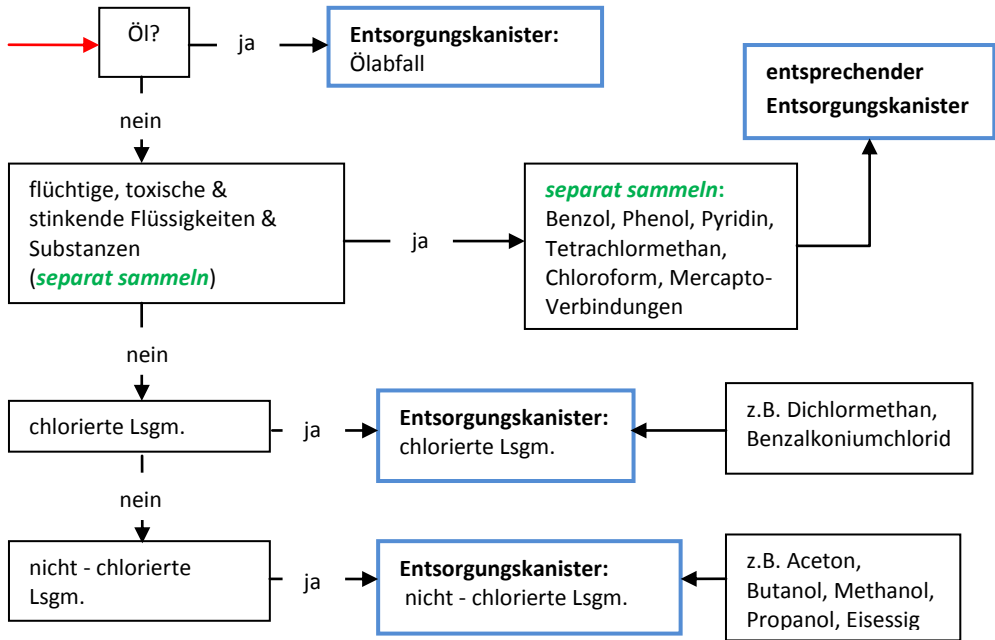

Merke: Alkohole mit einer Konzentration von über 20 mL/1 L Wasser gehören in den Entsorgungskanister!

Motto: Je giftiger, je stinkender, desto separater.